

Astra Tech Implant System und OsseoSpeed® übertreffen Mitbewerber in neuer Meta-Analyse¹

NEU VERÖFFENTLICHTE ERGEBNISSE MIT DENTSPLY SIRONA PRODUKTEN


11.077

Implantate mit OsseoSpeed, TiUnite und SLA/SLActive Oberflächen wurden verglichen

113

in die Meta-Analyse aufgenommene Publikationen

Eine aktuell durchgeführte Meta-Analyse¹ kommt zu dem Ergebnis, dass es einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen drei Premium-Implantatoberflächen gibt. Und OsseoSpeed ist der eindeutige Gewinner, wenn es um den Erhalt des marginalen Knochens nach einem sowie fünf Jahren geht.

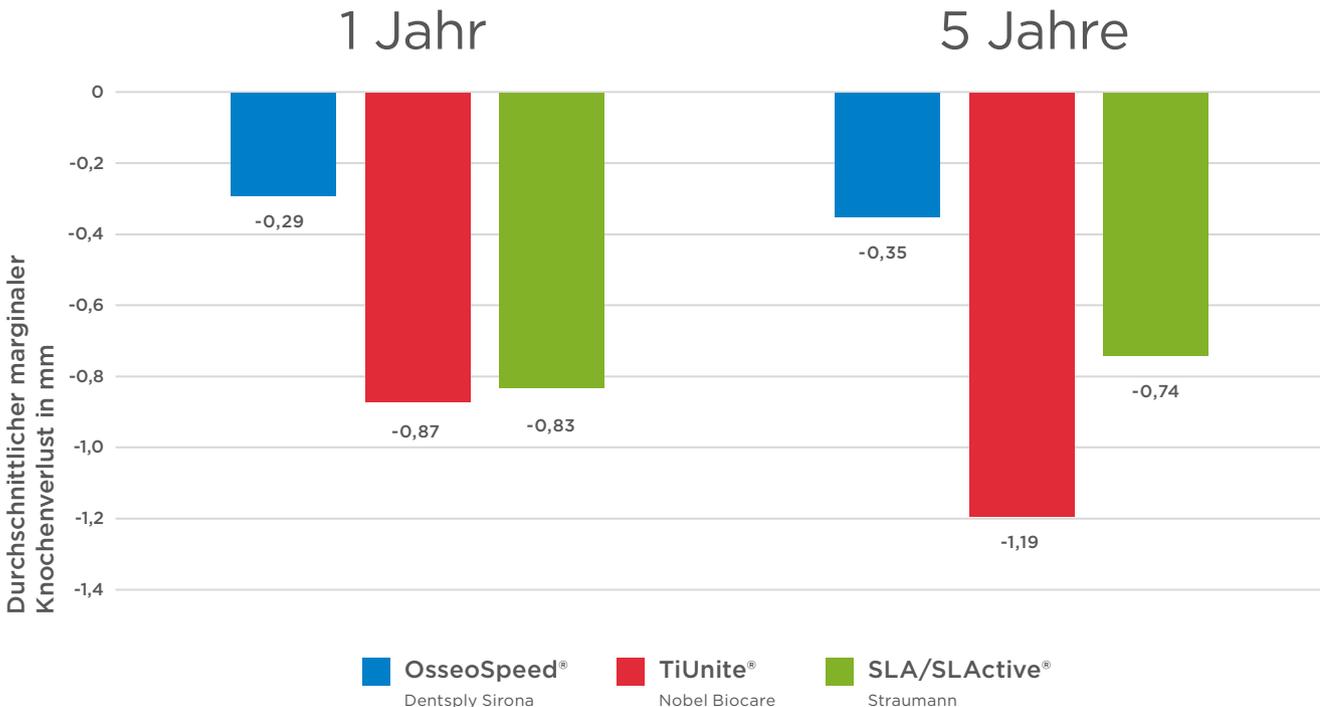

Lesen Sie mehr in JOMI:

¹Norton, MR, Astrom, M, The Influence of Implant Surface on Maintenance of Marginal Bone Levels for Three Premium Implant Brands: A Systematic Review and Meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2020;35(6):1099-111

Folgen Sie Dentsply Sirona für die neuesten Entwicklungen in der dentalen Implantologie



www.dentsplysirona.com/implants/science

